



2010年3月期 第2四半期 説明会資料

連結決算の概要

テルモ株式会社

代表者 代表取締役 社長 高橋 晃
問合せ先責任者 執行役員 広報室長 羽田野 彰士

TEL : 03-3217-6550

E-mail : kouhou_terumo01@terumo.co.jp

URL : <http://www.terumo.co.jp/>

平成 21 年 10 月 29 日

決算概要

(億円)

	09/3期 上期	10/3期 上期	増減率
売上高	1,570	1,581	1%
粗利益	843 (53.7%)	833 (52.7%)	-1%
販管費	528 (33.7%)	507 (32.1%)	-4%
営業利益	315 (20.0%)	326 (20.6%)	4%
経常利益	328 (20.9%)	322 (20.4%)	-2%
純利益	230 (14.6%)	208 (13.1%)	-10%

期中平均レート

US\$ 106円
EUR 163円


96円
133円

} 売上高に-7%影響

TERUMO


売上高 (地域別)

(億円)

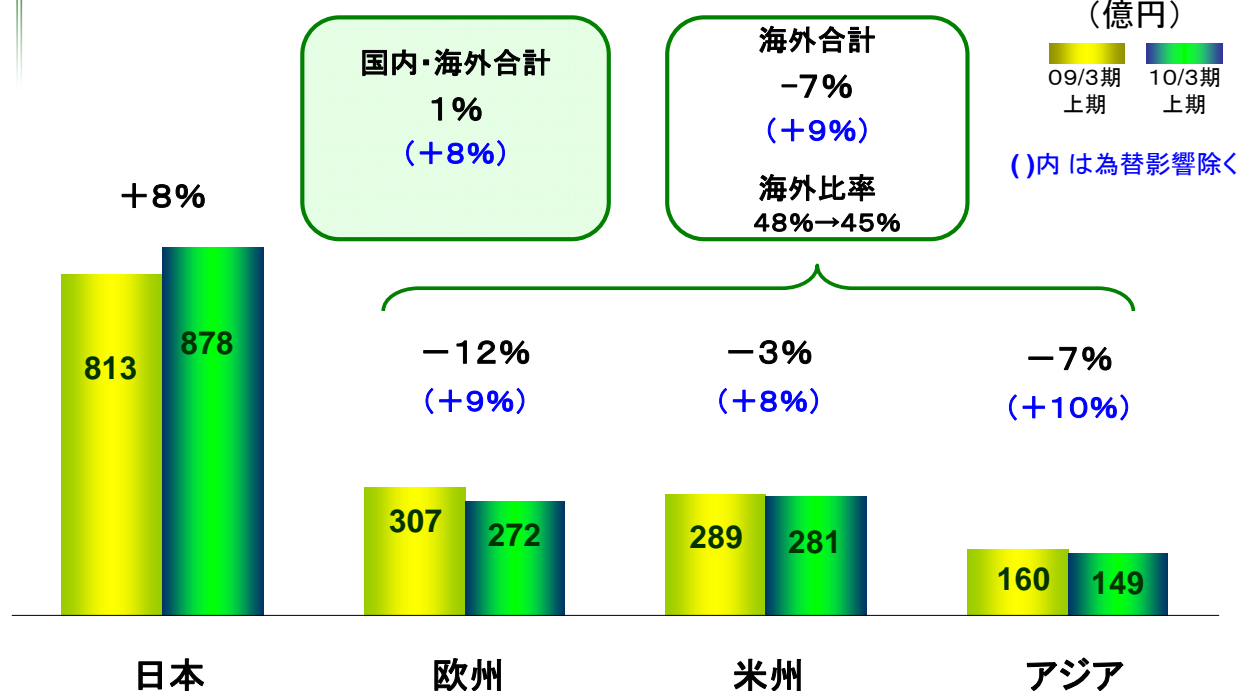


TERUMO

売上高 (商品群別)

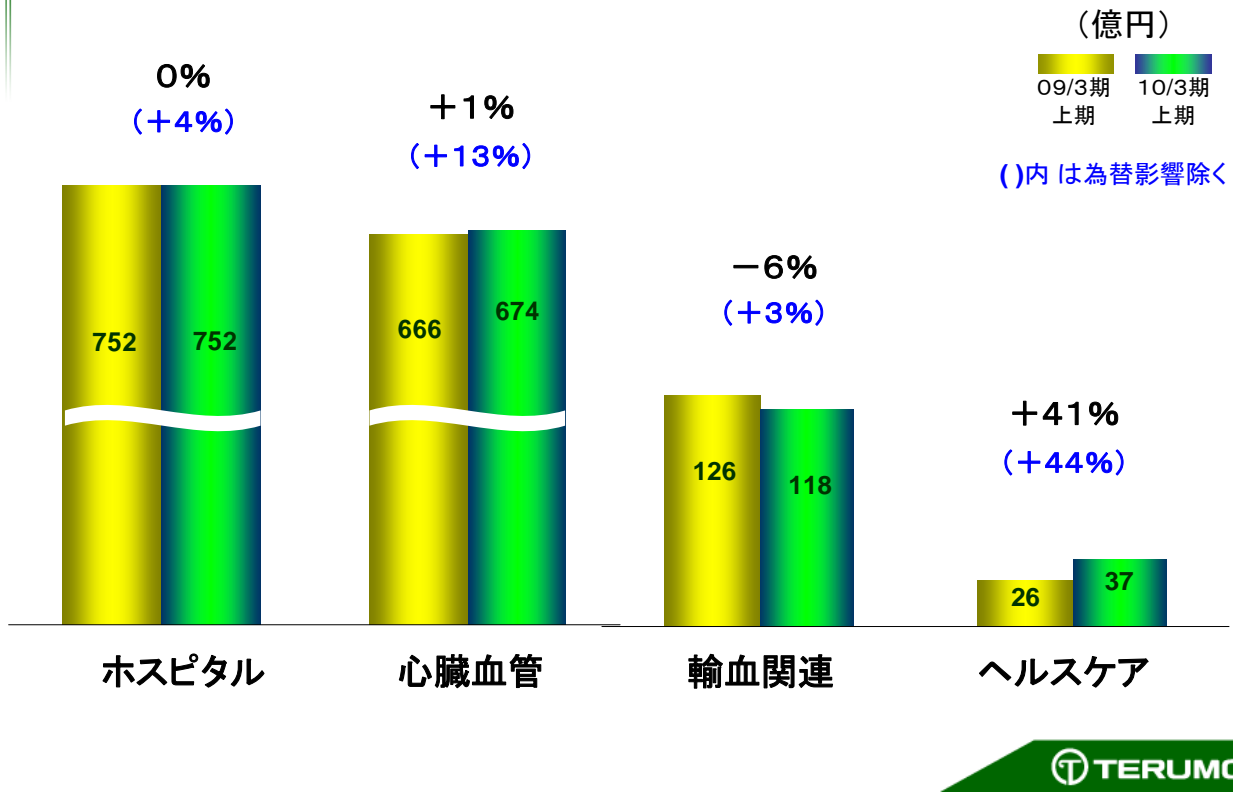

粗利益率、販管費率 双方が営業利益率の回復に貢献

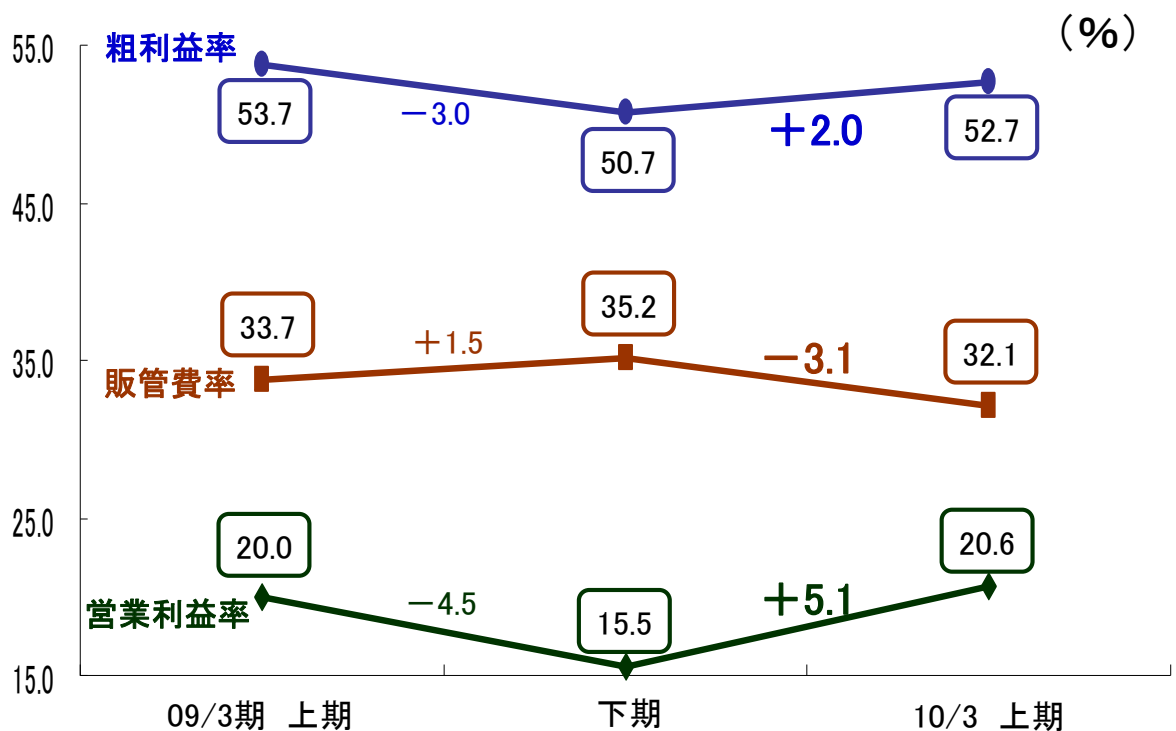

年間見通しを上方修正

下期は円高想定、開発費積極投下も営業利益20%堅持

(億円)

	10/3期 上期実績	10/3期 年間見通し	10/3期 当初見通し
売上高	1,581	3,150	3,150
営業利益	326 (20.6%)	630 (20.0%)	560 (17.8%)
経常利益	322 (20.4%)	610 (19.4%)	560 (17.8%)
純利益	208 (13.1%)	400 (12.7%)	375 (11.9%)
期中平均レート	US\$ 96 円 EUR 133 円	90 円 132 円	95円 125円

下期想定レート

US\$ 85 円
EUR 130 円

 TERUMO

2010年3月期 第2四半期決算 補足資料

セグメント別売上概況

(単位:百万円)

%=前年同期比

	2010年3月期 第2四半期累計					
	国内	%	海外	%	合計	%
ホスピタル医療器	25,505	1.4%	14,207	-15.5%	39,712	-5.4%
医薬品類	21,774	8.8%	5	-48.8%	21,779	8.8%
腹膜透析関連	3,319	-4.0%	-	-	3,319	-4.0%
糖尿病関連	7,607	5.2%	694	22.4%	8,302	6.5%
在宅医療関連	2,076	5.1%	-	-	2,076	5.1%
ホスピタル商品群 合計	60,282	4.2%	14,908	-14.2%	75,191	-0.0%
カテーテルシステム	14,090	15.6%	30,738	0.6%	44,828	4.8%
人工心臓システム	4,407	-0.1%	13,167	-12.9%	17,574	-10.0%
人工血管	1,031	31479.9%	3,977	-7.7%	5,009	16.2%
心臓・血管領域商品群 合計	19,529	17.6%	47,883	-4.2%	67,412	1.2%
輸血関連商品群 合計	4,640	0.2%	7,150	-10.1%	11,791	-6.3%
ヘルスケア商品群 合計	3,321	47.2%	347	3.1%	3,668	41.4%
総合計	87,774	7.9%	70,289	-7.1%	158,063	0.7%

(期中平均為替レート)

(US\$1=¥95.53)
(EUR1=¥133.21)

参考情報

(単位:百万円)

	2009年3月期 第2四半期累計	2010年3月期 第2四半期累計	2010年3月期 見通し
研究開発費	7,983	8,199	17,500
減価償却費	9,515	9,459	21,000
設備投資額	9,767	9,822	23,000
フリーキャッシュフロー	1,307	15,948	
<small>フリーキャッシュフロー=営業CF+投資CF</small>			
一株当たり純利益(円)	118.56	109.38	210.64

※テルモが開示する情報のうち、業績予想ならびに将来予測は、現時点で入手可能な限られた情報に基づき、テルモで判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため様々な要因により、実際の業績等が変動する可能性があることをご承知おきください。実際の業績に影響を与える重要な要素には、テルモの事業領域を取り巻く経済情勢、為替レートの変動、競争状況などがあります。