

機械器具 18 血圧検査又は脈波検査用器具
管理 自動電子血圧計 (JMDNコード: 16173000)

テルモ電子血圧計 P2000

(ES-P2000U用)

【警告】

<使用方法>

- 腕部に重度の血行障害のある場合は、医師に相談の上、慎重に適用すること。
[循環障害に伴う体調不良になる可能性がある。]
- 子供だけで使わせたり、自分で意思表示できない人に使用する場合は、医師に相談の上、慎重に適用すること。
[けがや事故が起きる可能性がある。]
- 透析治療中、又は抗凝固剤、抗血小板剤、ステロイド剤等を使用している場合は、医師に相談の上、慎重に適用すること。
[内出血を起こす可能性がある。]

【禁忌・禁止】


<使用方法>

- 測定結果の自己診断、治療は行わないこと。
[治療が必要な場合は、医師の診断のもとで行うことが必要である。]
- けがや治療中の腕では測定しないこと。
[症状が悪化する可能性がある。]
- 点滴静脈注射や輸血を行っている腕で測定しないこと。
[けがや事故が起きる可能性がある。]
- 引火性のある環境では使用しないこと。
[引火又は爆発の誘因となる可能性がある。]

*【形状・構造及び原理等】


<構造図>

血圧計本体

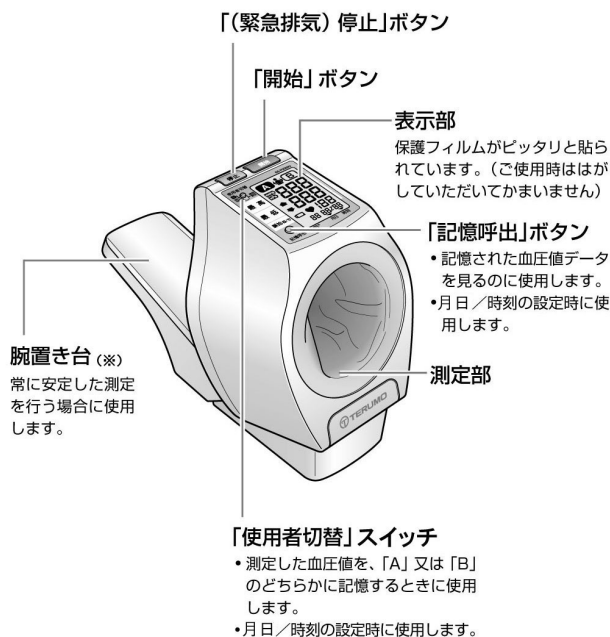

※測定可能な腕周囲：約18～33cm

付属品：※ACアダプタ (代表例)



電池フタ



※腕置き台、ACアダプタ

単品販売もある。製品の同梱内容については箱に記載。

*<原理>

本品は、マイクで検出した信号からフィルターコンパレータ法によりコロトコフ音を検出し、リバロッチ・コロトコフ法に基づき最高血圧及び最低血圧を測定して表示する。また、コロトコフ音又はカフ振動脈波の出現間隔を測定し、脈拍数を算出して表示する。

[電気的定格]

- 直流電源 (単2形乾電池4本 又は 充電電池4本)
電圧：6V 又は 4.8V
消費電力：9W
- 交流電源 (ACアダプタ)
定格電圧：100V
周波数：50又は60Hz
消費電力：25VA

[機器の分類]

電撃保護 クラスⅡ及び内部電源機器
B形装着部

※本品はEMC規格 JIS T 0601-1-2:2002 に適合している。

*【使用目的、効能又は効果】

<使用目的>

本品は最高血圧、最低血圧及び脈拍数の測定に用いる。

取扱説明書を必ずご参照ください。

*【品目仕様等】

<仕様>

測定方式：リバロッチ・コロトコフ法

測定部位：上腕

測定範囲：圧力 20～280mmHg

脈拍 30～160回/分

精度：圧力 ±4mmHg 脈拍 ±5%

加圧方式：自動加圧

減圧方式：自動減圧

排気方式：自動排気又は「停止」ボタンによる排気

表示方法：3桁デジタル

使用条件：温度 10～40℃ 相対湿度 30～85%RH

(ただし、結露なきこと)

警報機能：

・電池電圧低下表示機能、異常加圧防止機能、エラー表示機能

基本機能：

・表示部点検機能（「開始」ボタンを押すと、表示部が全灯し、表示部の点検を行う。終了後、表示が消え、血圧値表示部に「0」を表示する。）

・オートモード（「開始」ボタンを押すと、自動的に加圧され、加圧中は「加圧マーク」が点灯する。最高血圧の測定に必要な圧力値で自動的に加圧を停止、加圧停止後、自動的に減圧されて血圧の測定を行う。同時に脈拍数も測定する。）

・手動加圧モード（圧力表示が50mmHgになるまで「開始」ボタンを押し続けるとオートモードから手動加圧モードへ切り替わる。最高血圧の測定に必要な圧力値まで、「開始」ボタンを押し続け、加圧を続ける。加圧中は「加圧マーク」が点灯する。「開始」ボタンを離すと、加圧が停止し、自動的に減圧されて血圧の測定を行う。同時に脈拍数も測定する。）

・自動排気機能（測定終了後、自動的に大気圧まで急速排気される。）

・停止機能（測定中に「（緊急排気）停止」ボタンを押すと、電源が切れ、測定を中止し、ポンプが停止して大気圧まで急速排気される。）

・測定中表示機能（コロトコフ音が検出されると、これに同期して「測定中マーク」が点滅し、測定が終了すると消灯する。）

・オートパワーオフ機能（約3分30秒後、自動的に電源が切れる。）

*・メモリー切替機能（「使用者切替」スイッチを切替えることにより、測定値の記憶、呼出を行うメモリーをA、Bから選択することができる。また、選択されたメモリーのマークが表示される。）

・記憶データ表示機能（測定が終了すると、測定結果と測定した日時が選択されているメモリーに自動的に記憶される。「記憶呼出」ボタンを押すと測定された血圧値、脈拍数の平均値が表示される。その後、「記憶呼出」ボタンを押すごとに、測定された血圧値、脈拍数、記憶番号及び測定日時を表示する。ただし、測定がエラーの場合は記憶されない。）

・記憶データ消去機能（記憶されたデータを消去することができる。）

*・時計設定機能（「使用者切替」スイッチを時計設定にし、「開始」ボタンを押すと、時計モードとなり、時計を設定することができる。）

*【操作方法又は使用方法等】

【測定方法】

1. 上着やセーター、厚手のシャツ等を着用している場合は脱ぐ。（薄手のシャツやブラウスはそのまま測れる。）
2. 腕を測定部にひじが出るまでしっかり挿入し、正しい姿勢にする。

*3. 「使用者切替」スイッチでメモリーの選択を行う。

4. 「開始」ボタンを押して電源を入れる。（表示部の点検が終了後、自動的に加圧、減圧が行われる。）
5. 測定を途中で中止したいときには、「停止」ボタンを押す。
6. 測定終了後、表示される最高、最低血圧値と脈拍数を読み取る。
7. 連続して測定する場合は、改めて2.以降の操作を行う。
8. 「停止」ボタンを押して電源を切る。
9. 腕を抜く。

詳細については、取扱説明書を参照のこと。

<使用方法に関連する使用上の注意>

- ・手動加圧の場合、加圧を必要以上に高くしないこと。〔腕に一過性の内出血が発生することがある。〕
- ・測定する腕が水や汗等でぬれている場合は、必ずよく拭き取り、乾いてから使用すること。〔内部に水が浸入し故障や測定値の異常の原因となる。〕
- ・測定を始めるときや、測定終了後の腕の抜き差しは無理な力で行わないこと。〔本品の測定部が引っ張られ、破損することがある。〕
- ・取扱説明書に従い、腕を伸ばし、ひじが出るまで測定部に通すこと。〔測定部の位置が正しくないと、測定精度が保証できない。〕
- ・まくり上げたシャツ等で上腕を圧迫しないようにすること。〔測定値に誤差を生じたり、測定できない。〕
- ・いつも同じ腕で、手のひらを上に向けて測定すること。〔右腕と左腕では測定値に差が出る。〕
- ・安静な状態で測定すること。〔測定値が変化することがある。〕
- ・測定中に腕や手首、体を動かさないこと。〔エラーが表示されたり、再加圧することがある。〕
- ・腹部を圧迫した姿勢や、ひじを浮かせたり、ひじを極端に曲げた姿勢で測定しないこと。〔測定値が変化することがある。〕
- ・寒い部屋では測定しないこと。〔血圧が高くなる可能性がある。〕
- ・騒音や振動がある場所で測定しないこと。〔測定精度が保証できない。〕
- ・測定中は血圧計や載せているテーブル等をたたかないこと。〔測定精度が保証できない。〕
- ・連続測定によりうっ血した場合は、うっ血を取り除いてから測定すること。〔測定値が変化することがある。〕
- ・測定部を、はさみ等鋭利なもので傷つけないこと。〔測定値に誤差が生じたり、測定できない。〕
- ・本品に腕置き台を取り付ける場合は、無理に取り付けないこと。また取付け後は、確実に取り付けられていることを確認すること。〔無理に取り付けた場合や、確実に取付けが行われていない場合、腕置き台が破損する可能性がある。〕
- ・本品で測定を行う際、たたまれた状態の腕置き台を広げる場合には、指を挟まないよう十分注意すること。〔けがをする可能性がある。〕
- ・本品から腕置き台を取り外す場合には、腕置き台を広げてから取り外すこと。〔広げた状態でないと取外しができない。〕

*【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- ・使用の前に、外観に破損等がないことを確認し、異常が認められた場合、使用しないこと。〔測定値の異常や、けがの可能性が。〕
- ・添付文書及び取扱説明書を確認の上、使用すること。

- ・他の機器と併用するときは、影響の有無を確かめ、誤作動する場合には併用しないこと。
- ・付属及び専用のACアダプタ以外を使用しないこと。また、他の電気製品等に使用しないこと。[火災、感電の原因となる。]
- * 腕帯の締め付けにより、腕に一過性の内出血が発生することがある。痛みを感じたら「停止」ボタンを押して直ぐに測定をやめること。[内出血による赤みが腕に残る可能性がある。]
- ・測定部位の血流が少ない場合、血管音が非常に小さい場合、不整脈のある場合、血管雑音が多い場合は、慎重に適用すること。[測定者の体質や腕の形の影響により、測定値に誤差が生じたり、測定できない可能性がある。]
- ・本品に床への落下等による衝撃が加えられた場合は、使用しないこと。[本品の外観に異常が認められない場合でも、内部が破損している可能性がある。]
- ・本品に異物や液体が入らないように注意すること。もし入り込んだ場合、そのままの状態で使用しないこと。[故障の原因となる。]
- ・本品は気密構造ではないので、活性ガス（消毒用ガスも含む）環境や多湿環境等で使用、放置しないこと。[装置内部の電子部品に影響を与え、劣化や損傷により、故障の原因となる。]
- ・強い静電気や電磁波に近づけたり、近くで携帯電話を使用しないこと。[誤作動、故障の原因となる。]
- ・分解、修理、改造は行わないこと。[故障の原因となる。]
- ・電池の交換は、指定の同じ種類の新品の乾電池をすべて同時に行うこと。[古い電池を混ぜて使用すると電池が発熱し、故障の原因となる。]
- ・電池の交換はプラス、マイナスの向きを本品の表示に合わせて、マイナス側から入れること。[電池の向きを間違えたり、マイナス側の電極パネを無理に曲げて入れると、乾電池が発熱し、故障の原因となる。]
- ・ACアダプタのコードやコネクタが傷んだり、コンセントのさし込みがゆるい場合は、使用しないこと。[感電やショート、発火の原因となる。]
- ・ACアダプタをコンセントから抜くときは、コードを引っ張らずに必ずACアダプタを持つこと。またコネクタを本体から抜くときは、コネクタを持つこと。[コードを引っ張ると故障の原因となる。]
- ・ACアダプタのプラグにゴミ等を付着させないこと。[感電及び故障の原因となる。]
- ・ACアダプタを接続して長期間使用するときは、乾電池を取り外すこと。[乾電池を入れたままにすると、液漏れによる故障の原因となる。]
- ・ACアダプタのコードの上に重いものを置かないこと。[コードの破損により、火災、感電の原因となる。]
- ・ACアダプタのコードを釘等で固定しないこと。[コードの破損により、火災、感電の原因となる。]

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

＜貯蔵・保管方法＞

- ・水ぬれに注意し、日光及び高温多湿を避けて保管すること。
保管条件：周囲温度 -20～60℃ 相対湿度 10～95%RH
(ただし、結露なきこと)

[保管上の注意]

- ・本品、及び腕置き台は日光や紫外線等の強い光があたる場所に保管したり、長時間放置しないこと。[外装の変色や劣化が発生することがある。]
- ・振動、塵埃、腐食性ガス等の多い場所に保管しないこと。

- ・気圧、温度、湿度、風通し、塩分、イオウ分を含んだ空気等により悪影響の生じる可能性のある場所に保管しないこと。
- ・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。
- ・長時間使用しない場合、ACアダプタをコンセントから抜くこと。また、電池を使用している場合、電池を外しておくこと。[電池が液漏れし、故障の原因となる。ACアダプタの絶縁劣化により感電や漏電火災の可能性はある。]
- ・測定部にACアダプタ等の重いものを置かないこと。[内蔵マイクの破損により、故障の原因となる。]

＜有効期間・使用の期限＞

- ・標準的な使用期間の目安：4.5年（自己認証による）

【保守・点検に係る事項】

【保守・点検上の注意】

- ・しばらく使用しなかったときは、使用前に必ず作動（電源が入る、加圧するなど）を確認してから使用すること。
- ・血圧計本体、腕置き台、及びACアダプタをアルコール、シンナー、ベンジン等の有機溶剤、ポピドンヨードでは拭かないこと。[本品の破損や変色、故障の原因となる。]
- ・清掃するときは、必ず電源を切り、ACアダプタを抜いてから行うこと。その際、ぬれた手で抜き差ししないこと。[感電、けがの原因となる。]
- ・血圧計本体、腕置き台、及びACアダプタを水洗いしないこと。[故障の原因となる。]
- ・血圧計本体、又は腕置き台の汚れがひどい場合は、水又はぬるま湯を浸してよくしぼったガーゼ等で速やかに拭き取ること。
- ・ドライヤー等を使用して乾燥させないこと。[故障の原因となる。]

【包装】

- ・1台/箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：テルモ株式会社

住所：東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目4番1号

電話番号：0120-00-8178（テルモ・コールセンター）

製造業者：テルモ株式会社

